

管理医療機器 歯科用象牙質接着材

クリアファイル® DC ボンド

Dual Cure
Bonding system

デュアルキュアのボンディングが
1ステップに



デュアルキュア型ボンディングの操作性をよりシンプルに!

ボンドA液、ボンドB液の等量混和により、1ステップで接着処理が可能なデュアルキュア型ボンド(光・化学重合型)です。

※必ずボンドA液・ボンドB液を混和してご使用ください。ボンドA液は粘性があり、ボンドB液はサラッとした液性状です。採取の際は採取性の違いにご注意ください。



「クリアフィル® DCボンド」の使用ステップ概要

※ご使用の前には必ず製品の添付文書をお読みください。

case A レジンコアに | 歯科用支台築造材料を用いた支台築造

※添付文書に従って窩洞形成、防湿、充填準備を行ってください。

1 歯科用ポストの表面処理方法

金属ポストの場合
「アロプライマー」の塗布、エアーブロー

グラスファイバーポストの場合
リン酸エッチャング材処理後、「クリアフィル® セラミックプライマー」の塗布、エアーブロー

2 ボンドA液・B液の混和・塗布
※遮光下で保管し、90秒以内に使用してください。
20秒放置

3 強めのエアーブローでしっかりと乾燥
5秒以上

4 余剰ボンドを除去

5 再度強めのエアーブローでしっかりと乾燥
5秒以上

6 光照射
※照射器と照射時間の関係については表1をご参照ください。

7 支台築造用CRの填入・ポストの固定

8 支台築造用CRの築盛・支台形成

case B 光重合 CR に | 光重合型の歯科充填用コンポジットレジンを用いた充填修復

※添付文書に従って窩洞形成、防湿、歯髓保護、充填準備を行ってください。

1 ボンドA液・B液の混和・塗布
※遮光下で保管し、90秒以内に使用してください。
20秒放置

2 強めのエアーブローでしっかりと乾燥
5秒以上

3 光照射
※照射器と照射時間の関係については表1をご参照ください。

4 光重合型CRの充填

5 光照射
※照射時間は光重合型CRの添付文書に従ってください。

case C 化学重合 CR に | 化学重合型の歯科充填用コンポジットレジンを用いた充填修復

※添付文書に従って窩洞形成、防湿、歯髓保護、充填準備を行ってください。

1 ボンドA液・B液の混和
※遮光下で保管し、90秒以内に使用してください。
5秒以上混和

2 ボンドの塗布
20秒放置


3 強めのエアーブローでしっかりと乾燥
5秒以上

4 光照射
※照射器と照射時間の関係については表1をご参照ください。

5 化学重合型CRの練和・充填・硬化・仕上げ研磨

接着強さと照射時間

■「クリアフィル® AP-X」との接着強さ (MPa)

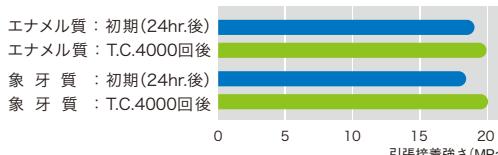

<測定条件>

ISO/TS 11405に準ずる

被着面積: 3mm²

光照射器: ジェットライト

照射時間: ボンド 10秒間光照射

CR 20秒間光照射

接着対象CR: 「クリアフィル® AP-X」

クラレノリタケデンタル(株)測定
弊社測定のデータ: 条件などにより数値が異なります。

■表1「クリアフィル® DCボンド」の照射時間について

歯科用支台築造材料を用いた支台築造	歯科用支台築造材料を用いた支台築造	その他の症例
従来型ハロゲン照射器、LED照射器	20秒間光照射	10秒間光照射
高出力ハロゲン照射器、プラズマーアーク照射器	10秒間光照射	5秒間光照射

使用可能な照射器については、添付文書をご参考ください。

管理医療機器 歯科用象牙質接着材

クリアフィル® DCボンド



セット
ボンドA液(4mL)×1本、
ボンドB液(4mL)×1本、
・付属品
(遮光板(B)×1個、混合皿(B)×1個、スポンジ小片(NL)×1箱)
メーカー希望小売価格: 17,000円 242-510

単品
・ボンドA液(4mL)×1本
メーカー希望小売価格: 9,000円 242-512
・ボンドB液(4mL)×1本
メーカー希望小売価格: 9,000円 242-513
●医療機器認証番号: 218ABBZX00039000

管理医療機器 歯科用支台築造材料

クリアフィル® DCコア オートミックス® ONE キット



セット(ホワイト、又はデンチン)
クリアフィル® DCコア オートミックス® ONE
Aベース 8.9g(4.5mL) + Bベース 9.0g(4.5mL) ×1本
クリアフィル® ボンド SE ONE
ボンド (1mL) ×1本

付属品(ホワイト、デンチン共通)

ミキシングチップ×20個、ガイドチップ(太)×10個、
ガイドチップ(細)10個、アブリケーター(ラング管用(黒))×50本、
遮光板(C)×1個、混合皿(C)×1個、
メーカー希望小売価格: 17,000円 242940-941
●医療機器認証番号: 223ABBZX00087000
クリアフィル® DCコア オートミックス® ONE キットはクリアフィル® DCコア オートミックス® ONE と
クリアフィル® ボンド SE ONE(少量タイプのボンド:1mL)のキットです。

管理医療機器 歯科セラミックス用接着材料

クリアフィル® セラミック プライマー



単品

4mL
メーカー希望小売価格 7,000円 242-550

●医療機器認証番号: 218ABBZX00041000

●メーカー希望小売価格の後の6ヶ所の数字は株式会社モリタの商品コードです。●掲載商品のメーカー希望小売価格は2012年4月現在のものです。メーカー希望小売価格には消費税等は含まれておりません。

●印刷のため、現品と色調が異なることがあります。●仕様及び外観は、製品改良のため予告無く変更することがありますので、予めご了承下さい。

●出典のない測定データはクラレノリタケデンタル株式会社によるものです。●ご使用に際しましては添付文書を必ずお読み下さい。

製品・各種技術に関するお問い合わせ

» クラレノリタケデンタル インフォメーションダイヤル

0120-330-922 月曜～金曜 10:00～17:00 www.kuraraynoritake.jp

製造販売元

クラレノリタケデンタル株式会社

〒959-2653 新潟県胎内市倉敷町2-28

連絡先

クラレノリタケデンタル株式会社

〒100-0004 東京都千代田区大手町1-1-3(大手センタービル)

フリーダイヤル: 0120-330-922

販売元

株式会社モリタ

〒564-8650 大阪府吹田市垂水町3-33-18

〒110-8513 東京都台東区上野2-11-15

<http://www.dental-plaza.com>

TEL.(06)6380-2525

TEL.(03)3834-6161